



CONTENTS

Advisory.....	4
Acoustics.....	5
Installation	6
Remote Control Function.....	9
Troubleshooting.....	10
Accessories.....	11

***Spanish translation begins on page 13.
La traducción en español inicia en la página 13.***

***French Canadian translation begins on page 23.
La traduction en Français débute à la page 23.***



If adjustable base does not operate or if parts are missing, call:

800-888-3078

Do not contact retail store or dealer.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT



WARNING

FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

ELECTRICAL RATING

Electrical components are rated for 110/120 voltage, 60Hz, 100 watt.

ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices. The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of base parts must be performed by authorized personnel.

LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

PRODUCT RATINGS

The base lift motors are *not* designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motor operation does not exceed five (5) minutes over a forty-five (45) minute period, or approximately 11% duty cycle. Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is 550 lb (249 kg) distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. ***Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.***

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. Avoid placing entire weight on head or foot section of the base, including when in the raised position. **DO NOT STAND ON BASE AT ANY TIME.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

CFR 1633 approved for use with most mattresses.

Assembled in USA.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

PACEMAKER WARNING

This product produces a vibrating sensation. It is possible that individuals with heart-assist pacemakers may experience a sensation similar to exercise. Consult physician for complete information.

HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases.

SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

ACOUSTICS

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment. For example, when a base is located on a hardwood floor with the massage feature in operation, a vibrating tone will be audible. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base.

INSTALLATION

For installation and setup, complete the following procedures, in the order indicated below and on the following pages:

STEP 1

Before discarding any packing materials, open the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:

- (1) Mattress Retainer
- (4) Bed Legs
- (1) Remote Control
- (1) Owners Manual
- (1) Warranty Sheet
- (1) Warranty Activation Card
- (1) Quick Setup Guide




OWNERS MANUAL



WARRANTY



**WARRANTY
ACTIVATION CARD**

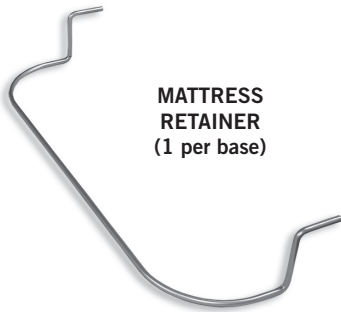

**MATTRESS
RETAINER
(1 per base)**



**LEG
(4 pieces)**



REMOTE CONTROL



QUICK SETUP GUIDE

INSTALLATION

STEP 2

Carefully lift the adjustable base frame from the shipping carton, keeping the unit top-side-down.

STEP 3

Install (4) legs into the base frame. Simply screw each leg into a tapped hole at each corner of the base frame (**FIGURE 1**).



WARNING

**AT LEAST TWO PEOPLE ARE
RECOMMENDED FOR HANDLING AND
MOVING ADJUSTABLE BASE.**



STEP 4

Remove and extend out power cord from the protective packaging.



WARNING

**POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH
ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.**

STEP 5

Remove the plastic packaging from the adjustable base frame. Carefully rotate the base frame over to position the base top-side-up.

INSTALLATION

STEP 6

Plug electrical power cord into a working, grounded electrical outlet.

Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).

STEP 7

Briefly activate all functions of the base with the remote control to verify all features are in working order. If base does not operate, refer to the *Troubleshooting* section of this manual.


STEP 8

Return base to the level position.

STEP 9

Install mattress retainer at the foot end of the base as follows:

- Locate grommets at foot of base (**FIGURE 2**).
- Place mattress retainer ends into grommets in top surface of adjustable base (**FIGURE 2**). Press down until horizontal retainer section is flush against base.

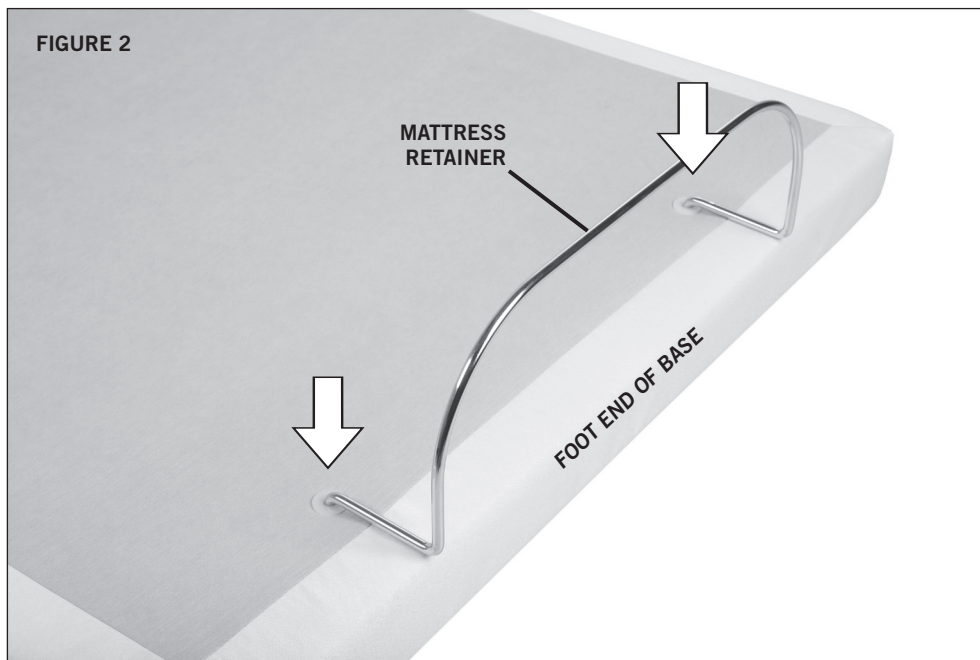


STEP 10

Install mattress on adjustable base.

Typical Vibrance™ adjustable base installation is now complete.

REMOTE CONTROL FUNCTION

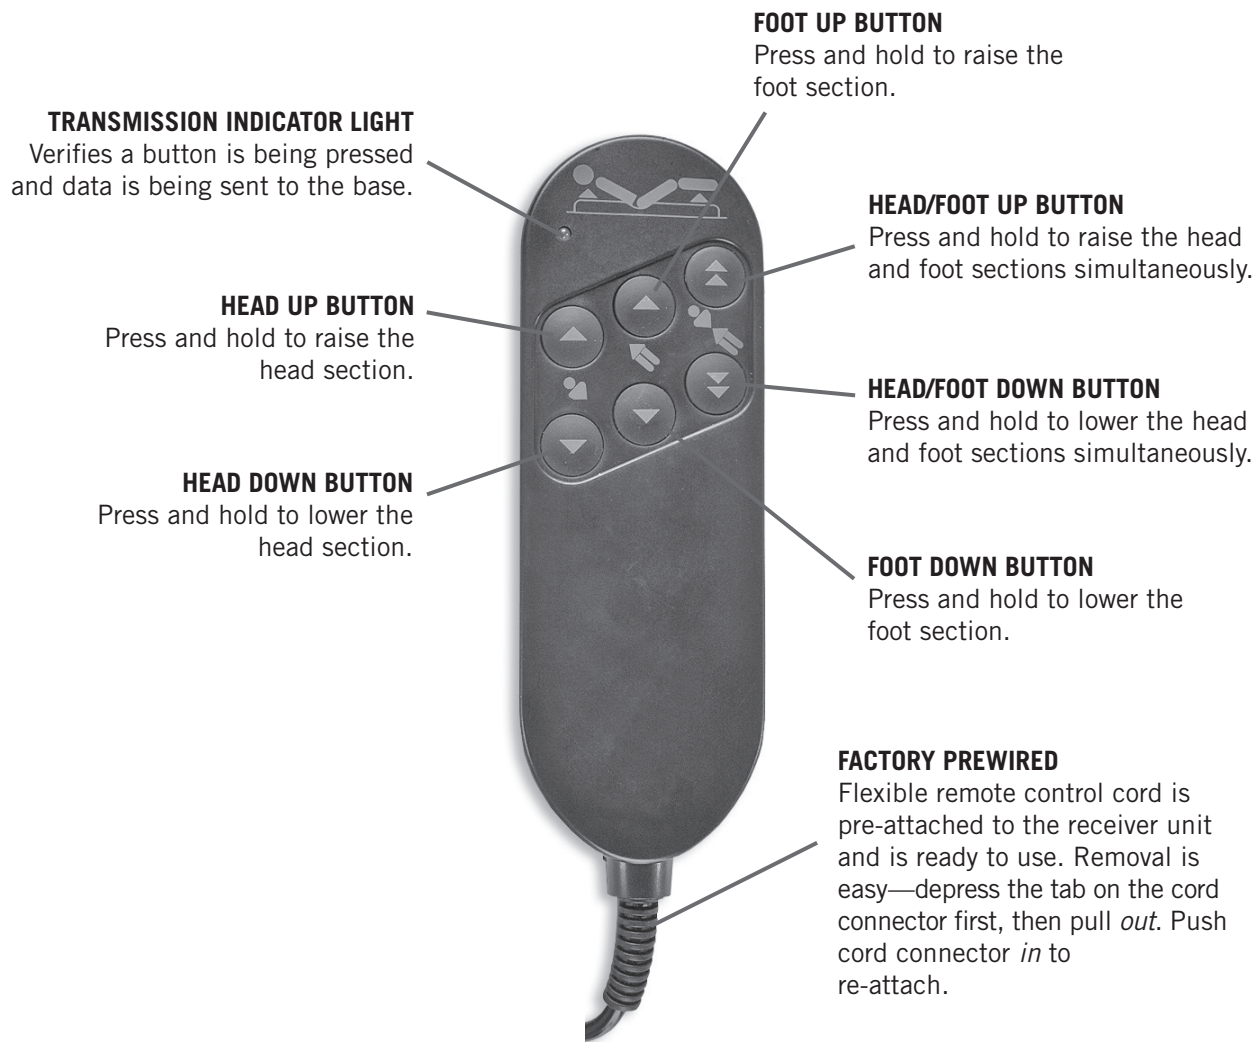

TROUBLESHOOTING

In the event the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below. For additional assistance call 800-888-3078.

SYMPTOM	SOLUTION
Remote control will not activate base.	• Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. <i>A grounded, electrical surge protection device is recommended.</i> Test outlet by plugging in another working appliance. • Verify remote control is plugged into the motor. • Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components. • Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify. • Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.
Head or foot section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.	• Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction. • Head section may be too close to the wall. • Headboard may be too close the edge of the mattress. Verify a 1.5" (38.1mm) to 2" (50.8mm) distance between headboard brackets and mattress. Adjust if required.

ACCESSORIES

OPTIONAL EQUIPMENT

Contact customer service toll free (800-888-3078) to order the accessories indicated in the chart below.

ACCESSORY DESCRIPTION	CODE	IMAGE
Wired Remote Control Cable - Dual DC Motor	4B5431	
Head Board Brackets-TXL	4B6117	
Head Board Brackets-FXL/Q	4B6118	
Push-in Locking Casters (set of 4)	4B1806	
Bed Link Kit (connects two bases together)	4B7410	
Rubber Caster Cups (set of 4)	4B1034	
Leg Extension Kit	4B7365	

CONTENIDOS

Recomendaciones.....	14
Acústica	15
Instalación	16
Funcionamiento del control remoto.....	19
Resolución de problemas.....	20
Accesorios	21



Si la base ajustable no funciona o si hay partes faltantes, llame al:

800-888-3078

Por favor no contacte al distribuidor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Los componentes eléctricos están previstos para un voltaje de 110/120, 60Hz, 100 watt.

CONEXIÓN A TIERRA

Este producto está equipado con un cable eléctrico conectado a tierra o polarizado. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA

No abra ninguna caja de control, motores o dispositivos de control remoto. La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes. La garantía perderá validez si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de alguna de las partes de la base ajustable deberá efectuarse por personal autorizado.

LUBRICACIÓN

El diseño de este producto permite prescindir de mantenimiento. Los motores de elevación están lubricados y sellados en forma permanente, por lo que no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos principales del motor de elevación o en las tuercas de nylon, o la base podría descender inadvertidamente desde la posición de elevación.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los motores de elevación de la base **no** están diseñados para el uso continuo. Para mayor seguridad y máxima vida útil, no se deberán operar los motores de elevación por más de cinco (5) minutos en un período de cuarenta y cinco (45) minutos, o aproximadamente el 11% del ciclo de trabajo. Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso máximo recomendado (incluyendo el colchón) es de 249 kg (550 lb) distribuido uniformemente a través de la base. La base soportará estructuralmente los pesos recomendados, distribuidos de manera uniforme entre su cabecera y pie. Este producto no está diseñado para soportar o elevar estos pesos sólo en las secciones de la cabecera o pie. ***Nota: Exceder las restricciones de los pesos recomendados podría dañar su base e invalidar la garantía.***

Para un mejor rendimiento, se debe entrar y salir de la cama ajustable mientras la misma está en posición plana (horizontal). Evite colocar todo el peso en las secciones de la cabeza o los pies de la base, incluso cuando esté en la posición elevada.

NO SE PARE EN LA BASE EN NINGÚN MOMENTO.

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories).

CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones.

Ensamblado en los Estados Unidos.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA CON NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Después de desembalar la base, deseche inmediatamente el material de embalaje, ya que puede producir asfixia a niños pequeños y mascotas. Para evitar lesiones, los niños o mascotas no deberán jugar bajo o sobre la base. No deben, asimismo, operar esta base sin la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA POR MARCAPASOS

Este producto genera una sensación de vibración. Es posible que los individuos con marcapasos experimenten una sensación similar a cuando realizan ejercicio. Consulte al médico para obtener más información.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS

Esta base ha sido diseñada sólo para uso doméstico.

No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No utilice esta base con equipos para terapias de oxígeno, ni la ubique cerca de gases explosivos.

REQUISITOS DEL SERVICIO

Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles o retirar cabeceras, pieceras o cualquier otro elemento para realizar el mantenimiento de su base. En caso de que el técnico no pueda brindar el servicio debido a inaccesibilidad, el comprador deberá pagar y reprogramar la visita.

ACÚSTICA

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto produce una leve tensión en los componentes en movimiento, y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si ocurrieran vibración o ruido excesivos, revierta el movimiento (ascendente o descendente) de la base con el control manual. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base para que quede en la posición de funcionamiento adecuada.

ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO

El nivel de sonido durante el funcionamiento de la cama se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada. Por ejemplo, si la base se encuentra sobre un piso de madera dura con la función de masajes activada, se escuchará un sonido de vibración. Para reducirlo al mínimo, coloque un trozo de alfombra, o sujetadores de goma opcionales, debajo de cada pata o rueda de la base.

INSTALACIÓN

Para la instalación y configuración, complete los siguientes procedimientos, en el orden que se indica a continuación y en las siguientes páginas:

PASO 1

Antes de deshacerse de cualquier material de empaçado, revise la caja de envío de la base ajustable y verifique que se incluyan los siguientes artículos:

- (1) Sujetador de colchón
- (4) Patas para cama
- (1) Control remoto
- (1) Manual del propietario
- (1) Hoja de garantía
- (1) Tarjeta de Activación de Garantía
- (1) Guía rápida de configuración



MANUAL DEL PROPIETARIO



GARANTÍA



TARJETA DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA



SUJETADOR DE COLCHÓN
(1 por base)



PATAS
(4 piezas)



CONTROL REMOTO



GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

INSTALACIÓN

PASO 2

Levante cuidadosamente el marco de la base de la ajustable para sacarlo de la caja de envío, manteniendo la unidad con la parte superior orientada hacia abajo.

PASO 3

Monte 4 patas en el marco de la base. Simplemente atornille cada pata en un orificio con rosca en cada esquina del marco de la base (**FIGURA 1**).

ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE POR LO MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE AJUSTABLE.



PASO 4

Retire el embalaje de protección del cable de alimentación y extiéndalo.

ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

PASO 5

Retire el empaque de plástico del marco de la base de la ajustable. Gire con cuidado la base ajustable hasta colocarla con la superficie hacia arriba.

INSTALACIÓN

PASO 6

Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra. ***Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica (no incluido).***

PASO 7

Brevemente active todas las funciones de la base con el control remoto para verificar que todas las características están funcionando. Si la base no funciona, consulte la sección *Resolución de problemas* de este manual.


PASO 8

Coloque nuevamente la base en posición horizontal.

PASO 9

Instale el sujetador de colchón en el extremo del pie de la base de la siguiente manera:

- Ubique los orificios con sello en el pie de la base (**FIGURA 2**).
- Coloque los extremos del sujetador de colchón en los orificios con sello de la superficie de la base ajustable (**FIGURA 2**). Presiónelo hacia abajo hasta que la sección horizontal del sujetador se alinee con la base.

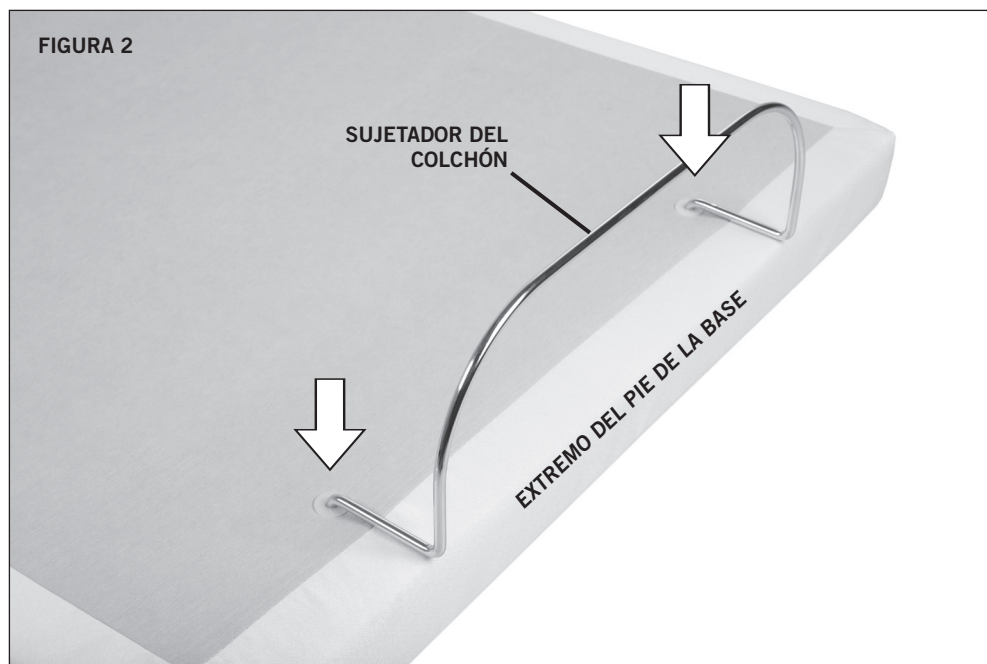


PASO 10

Instale el colchón en la base ajustable.

Usted ha terminado la instalación típica de la base ajustable Vibrance™.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

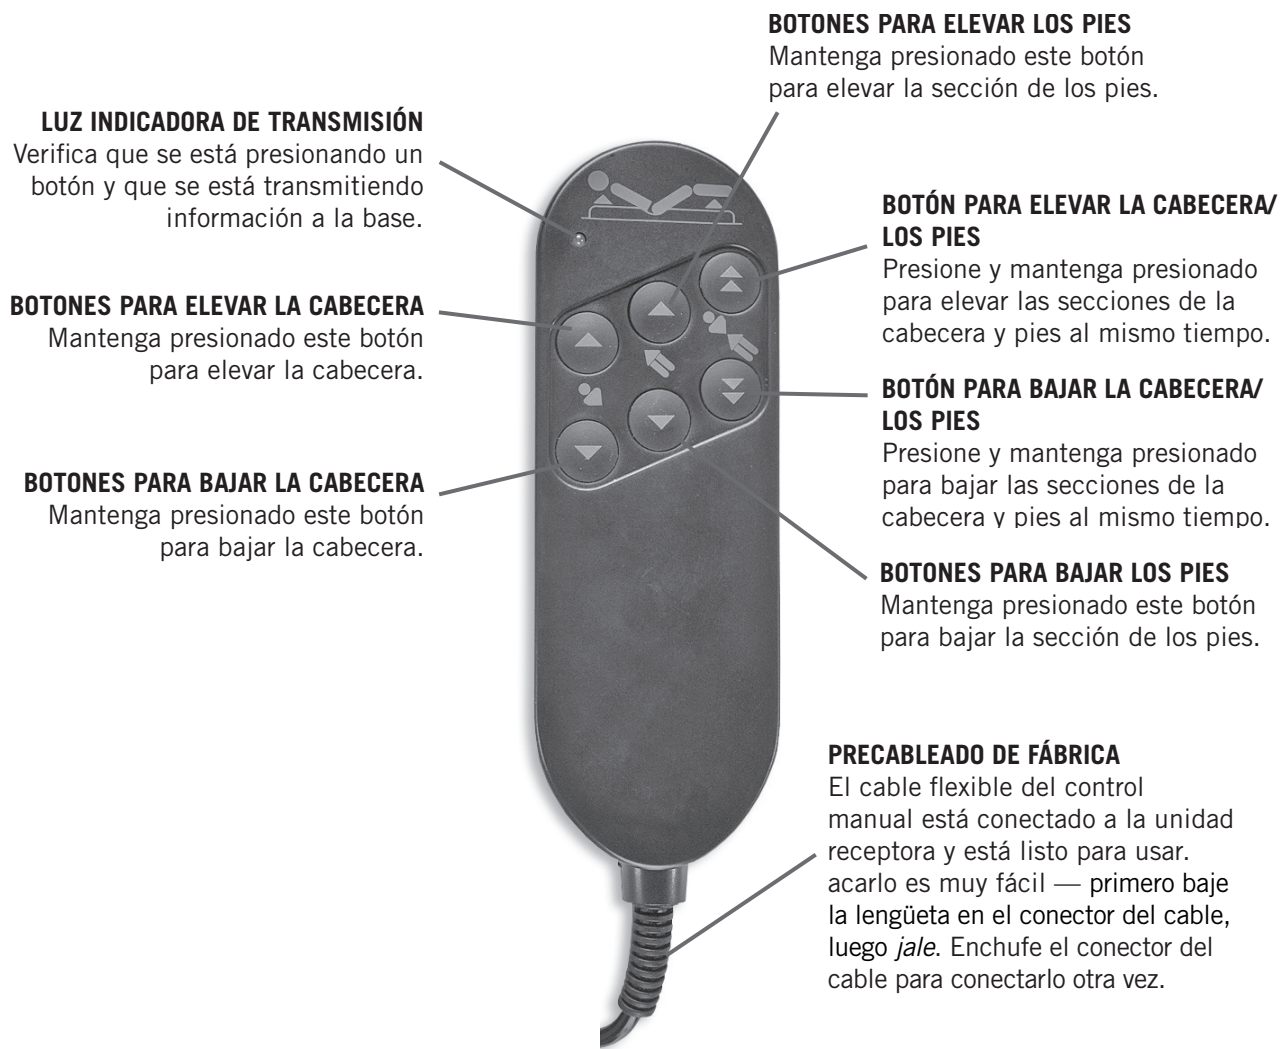

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación. Para más ayuda, llame al 800-888-3078.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto no activa la base.	• Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. <i>Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra.</i> Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione. • Verifique que el control remoto esté conectado al motor. • Desechufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y enchufe nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. • El interruptor eléctrico puede estar activado. Verifique la caja del interruptor eléctrico para comprobarlo. • Dispositivo de protección contra sobretensión o tomacorriente defectuoso. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.
La sección de la cabecera o de los pies se eleva, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	• El mecanismo de la base puede estar obstruido. Eleve la base y verifique si hay una obstrucción. Elimínela. • La sección de la cabecera puede estar muy cerca de la pared. • La cabecera puede estar muy cerca del borde del colchón. Verifique que haya una distancia de 1.5" (38.1 mm) a 2" (50.8 mm) entre el soporte de la cabecera y el colchón. Ajuste de ser necesario.

ACCESORIOS

EQUIPO OPCIONAL

Comuníquese con el servicio al cliente al número libre de cargos (800-888-3078) para ordenar los accesorios indicados en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS	CÓDIGO	IMAGEN
Cable para control remoto - Motor dual CC	4B5431	
Soportes de la cabecera-TXL	4B6117	
Soportes de la cabecera-FXL/Q	4B6118	
Ruedas bloqueables a presión (juego de 4)	4B1806	
Kit de unión para cama (conecta dos bases)	4B7410	
Apoyos de goma para ruedas (juego de 4)	4B1034	
Kit de extensión para patas	4B7365	

SOMMAIRE

Directives de sécurité.....	24
Acoustique	25
Installation	26
Fonction de télécommande.....	29
Dépannage.....	30
Accessoires	31



Si la base réglable ne fonctionne pas ou si des pièces sont manquantes, appelez :
800-888-3078

Veuillez vous abstenir de contacter le détaillant.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT



AVERTISSEMENT

POUR UNE OPÉRATION DE BASE RÉGLABLE OPTIMALE, UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE SURTENSION ÉLECTRIQUE RELIÉ À LA TERRE (NON INCLUS). L'OMISSION D'UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ OU ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU PRODUIT.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES NOMINALES

Les valeurs nominales pour les composantes électriques sont 110/120 volts, 60 Hz, 100 watts.

MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

Ce produit est équipé d'un cordon d'alimentation électrique polarisée ou relié à la terre. Le cordon ne s'insérera que dans un dispositif de protection contre les surtensions (non fourni) ou une prise électrique avec mise à la terre.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA GARANTIE

Ne pas ouvrir les boîtiers de contrôle, les moteurs ou les télécommandes. Toute tentative d'ouvrir ces composants entraînera l'annulation de la garantie. La garantie sera également annulée si vous tentez de modifier le filage des composants, ou d'ajuster ou modifier la structure du produit de quelque manière que ce soit. Toute réparation ou remplacement des pièces de base doit être effectué par du personnel autorisé.

LUBRIFICATION

Ce produit a été conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de soulèvement sont lubrifiés en permanence et scellés, de sorte qu'aucune lubrification supplémentaire n'est requise. N'appliquez donc pas de lubrifiant sur les filets d'engagement du moteur de soulèvement ni sur les écrous en nylon, sinon le base risque de perdre son élévation.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT

Les moteurs de soulèvement du base **ne** sont **pas** conçus pour un usage continu. La fiabilité de fonctionnement et la pleine durée prévue seront réalisés à la condition que les moteurs de soulèvement ne fonctionnent pas plus de cinq (5) minutes sur une période de 45 minutes, c'est-à-dire un pourcentage d'utilisation d'environ 11 %. Toute tentative de contourner ou dépasser ces caractéristiques nominales vont diminuer la durée de vie du produit et risquent d'annuler la garantie.

Les poids maximale recommandée (inclus le matelas) est de 249 kg (550 lb) réparties uniformément à travers la base. La structure du base supportera les poids recommandés s'ils sont répartis uniformément de la tête au pied. Ce lit n'est pas conçu pour supporter ou soulever ces poids s'ils sont concentrés dans la zone de la tête ou des pieds. **Remarque :** *L'omission de respecter les restrictions de poids peut endommager le base et annuler la garantie.*

Pour le meilleur rendement, le lit réglable doit se trouver à plat (position horizontale) au moment d'y entrer et d'en sortir. Éviter de mettre tout le poids à la tête ou au pied de la section de la base, incluant lorsqu'en position levée. **NE PAS SE TERNIR DEBOUT SUR LA BASE, EN AUCUN TEMPS.**

UL (Underwriters Laboratories) coté.

CFR 1633 approuvé pour utiliser avec la majorité des matelas.

Assemblé aux États-Unis.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

MISE EN GARDE CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Après que la base soit déballée, disposer immédiatement du matériau d'emballage, car il peut étouffer les jeunes enfants et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, les enfants ou les animaux domestiques ne devraient pas être autorisés à jouer sur ou sous la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner cette base, sans surveillance d'un adulte.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES STIMULATEURS CARDIAQUES (PACEMAKER)

Ce produit génère des vibrations. La sensation éprouvée par les personnes munies d'un stimulateur cardiaque peut s'apparenter à de l'exercice physique. Consultez un médecin pour de plus amples renseignements.

CLAUDE DE DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DES HÔPITAUX

Cette base est conçue pour une utilisation à domicile seulement. Elle n'est pas approuvée pour l'usage hospitalier et n'est pas conforme aux normes hospitalières. Ne pas utiliser cette base avec de l'équipement de oxygénothérapie de type tente ou utiliser à proximité de gaz explosifs.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

Les techniciens de service ne sont pas responsables du déplacement des meubles, à retirer les têtes de lit et pieds de lit ou tout autre élément requis pour effectuer la maintenance sur la base. Dans l'éventualité où le technicien est incapable de fournir le service à cause de l'inaccessibilité, l'appel de service sera tout de même facturé à l'acheteur et devra être remis à une date ultérieure.

ACOUSTIQUE

MÉCANISME DE SOULÈVEMENT ET D'ABAISSMENT

Le mécanisme de soulèvement et d'abaissement émettra un faible ronronnement en cours de fonctionnement. Ce son est tout à fait normal.

Pendant le fonctionnement, les roues de bras de levage entrent en contact avec le support de plate-forme de la base. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. Si un bruit ou vibration excessive est initié, inverser l'action du mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base avec la commande manuelle. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation de la base à la bonne position opérationnelle.

CONDITIONS AMBIANTES

Le niveau sonore perçu lors du fonctionnement est en lien direct avec les conditions ambiantes. Par exemple, si une base est située sur un plancher de bois franc avec la fonction de massage activée, un ton vibrant sera audible. Afin de minimiser cette résonance, placez un morceau de tapis, ou capuchons à roulette en caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base.

INSTALLATION

Pour l'installation et la mise en place, effectuez les procédures suivantes, dans l'ordre indiqué ci-dessous et aux pages suivantes :

ÉTAPE 1

Avant de disposer de l'emballage, ouvrez la boîte dans laquelle la base réglable vous a été livrée et vérifiez que les articles suivants y sont inclus :

- (1) Dispositif de retenue du matelas
- (4) Pieds du Lit
- (1) Télécommande
- (1) Guide d'utilisation
- (1) Feuille de la garantie
- (1) Carte d'enregistrement de la garantie
- (1) Guide d'installation rapide




GUIDE D'UTILISATION



GARANTIE



CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

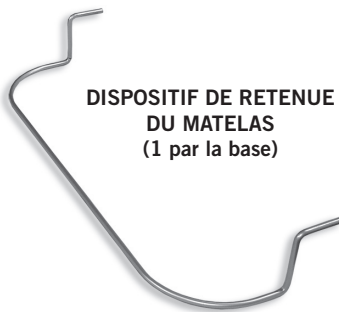

**DISPOSITIF DE RETENUE DU MATELAS
(1 par la base)**



**PIED
(4 pièces)**



TÉLÉCOMMANDE



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

INSTALLATION

ÉTAPE 2

Soulever délicatement le cadre de base ajustable hors de la boîte de transport, en maintenant le haut de l'unité vers le bas.

ÉTAPE 3

Installez quatre (4) pieds sur le cadre de base de lit. Vissez simplement chaque pieds dans le trou taraudé à chaque coin du cadre (**FIGURE 1**).

AVERTISSEMENT

DEUX PERSONNES AU MOINS SONT REQUISES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE RÉGLABLE.



ÉTAPE 4

Retirez le cordon électrique de son emballage de protection et déployez-le.

AVERTISSEMENT

LES CORDONS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DU BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 5

Retirer l'emballage plastique du cadre de la base ajustable. Faire pivoter délicatement la base réglable afin de placer le dessus de la base vers le haut.

INSTALLATION

ÉTAPE 6

Branchez le cordon électrique dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre.

Remarque : Un dispositif de protection contre les surtensions est recommandé (non fourni).

ÉTAPE 7

Activez brièvement toutes les fonctions du base avec la commande pour vérifier qu'elles fonctionnent bien. Si le base ne fonctionne pas, reportez-vous à la section *Dépannage* de ce manuel.


ÉTAPE 8

Remettez le base à la position horizontale.

ÉTAPE 9

Installez la retenue de matelas à l'extrémité de pied de la base réglable comme suit:

- Repérez les trous munis d'œilletons au extrémité de pied de la base (**FIGURE 2**).
- Veuillez placer les extrémités du dispositif de retenue du matelas dans les trous à œillet, sur la surface supérieure de la base du réglable (**FIGURE 2**). Appuyez vers le bas jusqu'à ce que la section horizontale du dispositif de retenue soit tout contre la base.

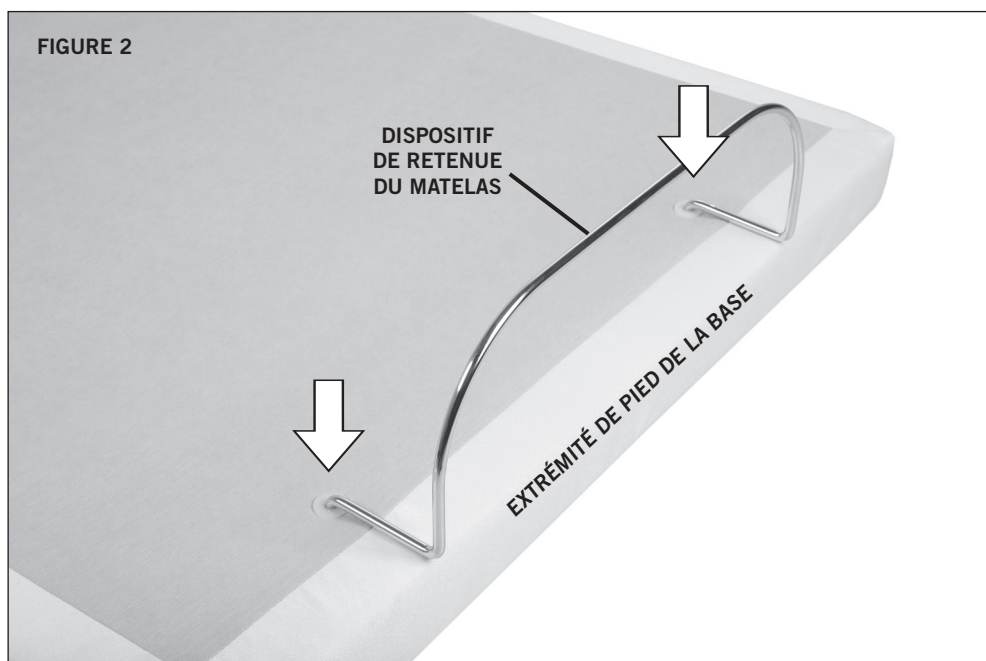

ÉTAPE 10

Installez le matelas sur la base réglable.

L'installation de la base de lit réglable des modèles types de la Vibrance™ est maintenant complétée.

FONCTION DE TÉLÉCOMMANDE



DÉPANNAGE

Dans le cas où la base réglable ne fonctionne pas, analyser les symptômes et solutions possibles prévues dans le tableau ci-dessous. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, composer le 800-888-3078.

SYMPTÔME	SOLUTION
La télécommande n'active pas la base réglable.	• Vérifiez que le cordon électrique est branché dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre. L'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions avec mise à la terre est recommandée. Vérifiez la prise en y branchant un autre appareil électrique fonctionnel. • Vérifiez que la télécommande est branchée au moteur. • Débranchez le cordon électrique, attendez 30 secondes puis rebranchez-le pour réinitialiser les composants électroniques. • Le disjoncteur du circuit électrique est peut-être déclenché. Vérifiez si c'est le cas dans le coffret de branchement (boîte électrique). • Une défaillance du dispositif de protection contre les surtensions ou de la prise électrique. Vérifiez la prise en y branchant un autre appareil électrique fonctionnel.
La zone de la tête ou des pieds s'élève, mais elle ne revient pas à la position horizontale (à plat).	• Le mécanisme de la base peut être obstrué. Relevez la base et vérifiez l'obstruction. Retirez l'obstruction. • La zone de la tête peut être trop près du mur. • La tête de lit peut être trop près du bord du matelas. Vérifiez la distance de 1,5 po (38.1 mm) à 2 po (50.8 mm) requise entre les supports de tête de lit et le matelas. Procédez à un ajustement le cas échéant.

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Veuillez contacter le service à la clientèle en composant le numéro sans frais (800-888-3078) pour commander les accessoires indiqués dans le tableau ci-dessous.

DESCRIPTION D'ACCESSOIRE	CODE	IMAGE
Câble de commande à distance câblée – Moteur CC double	4B5431	
Ferrures de tête de lit JTL	4B6117	
Ferrures de tête de lit D/TGTL	4B6118	
Roulettes encastrées verrouillables (jeu de 4)	4B1806	
Trousse de raccordement pour lit (raccorde deux bases ensemble)	4B7410	
Coupes pour roulette en caoutchouc (jeu de 4)	4B1034	
Trousse d'extension de pied	4B7365	

NATIONWIDE CUSTOMER SERVICE toll free: (800) 888-3078

© 2015 Leggett & Platt Adjustable Bed Group, a division of Leggett & Platt Incorporated

